



オイル診断計 WIO/T-WIO-006

Oilcheck System WIO / T-WIO-006

特長 FEATURES

- オイルの水分活性値を0.00~1.00aw で表示
- オンラインで常時監視可能
- わずかな水分量を検出可能
- LED 簡易表示(閾値0.5、0.9aw 固定)
- 表示器に警報出力
(リレーa 接点、2回路、閾値任意設定)

型式 MODEL


T-WIO-006-S-2

Sタイプ: センサヘッド+表示器


Uタイプ: センサヘッド



外形図 EXTERNAL DIMENSIONS



接続例 CONNECTION EXAMPLE

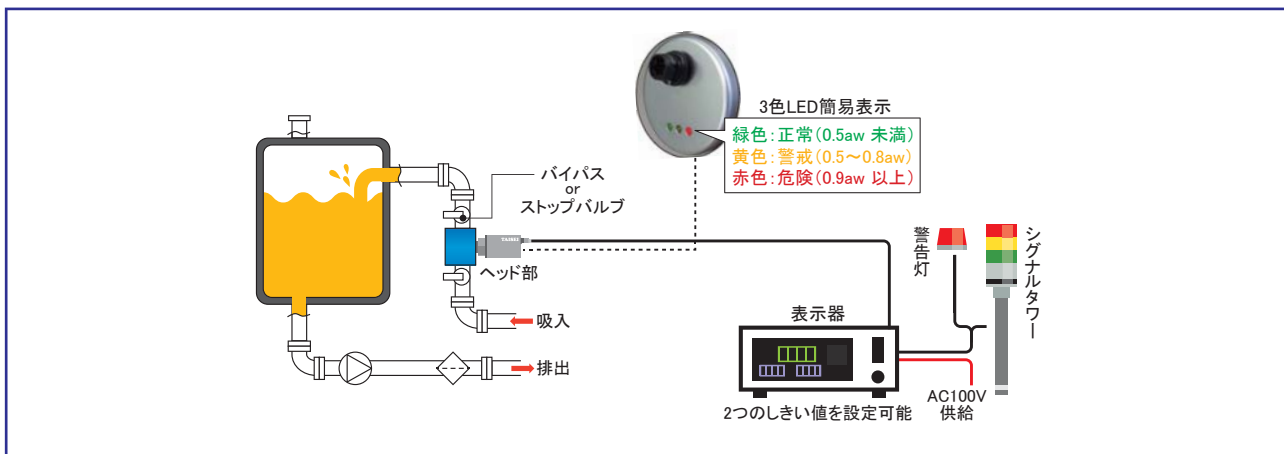

仕様 SPECIFICATIONS

センサヘッド仕様

動作温度	0℃~+80℃
電源電圧	DC24V±10%(60mA以下)
測定出力	4~20mA(0.00~1.00aw)*1
質量	約400g
保護等級	IP65
適用媒体	潤滑油、作動油
耐圧力	0~6.0MPa

*1 アナログ出力ケーブル使用

表示器仕様

動作温度	0℃~+40℃
電源電圧	AC100~240V±10%(100V時12VAmx)
表示出力範囲	0.00~1.00aw
リレー出力	AL1、AL2(閾値任意 a 接点)
測定出力	4~20mA(0.00~1.00aw)
質量	約950g
外形寸法	150mm×150mm×80mm
表示器ケーブル	ケーブル長: 2m

★製品仕様は、改良のため変更することがあります。Specifications of products are subject to change without notice.

oilcheck_T-WIO-006-02



株式会社 MKTタイセイ

【本社】〒171-0022 東京都豊島区南池袋3-10-8 第1野萩ビル
 TEL: (03) 3982-0029 (代) FAX: (03) 3986-1537 E-mail: info@mkt-taisei.com
 【関西営業所】〒532-0011 大阪府淀川区西中島3-18-9 新大阪日大ビル513
 TEL: (06) 6390-7264 FAX: (06) 6390-6945

MKT TAISEI Co.,Ltd.

【Head Office】3-10-8, Nohagi 1st Bldg, Minami-Ikebukuro, Toshima-ku, Tokyo, 171-0022, Japan.
 PHONE: 81-3-3982-0029 FAX: 81-3-3986-1537 E-mail: info@mkt-taisei.com
 【Kansai Branch】3-18-9, Nishi-Nakajima, Yodogawa-ku, Osaka-City, 532-0011, Japan.
 PHONE: 81-6-6390-7264 FAX: 81-6-6390-6945